




SU ANALIZI

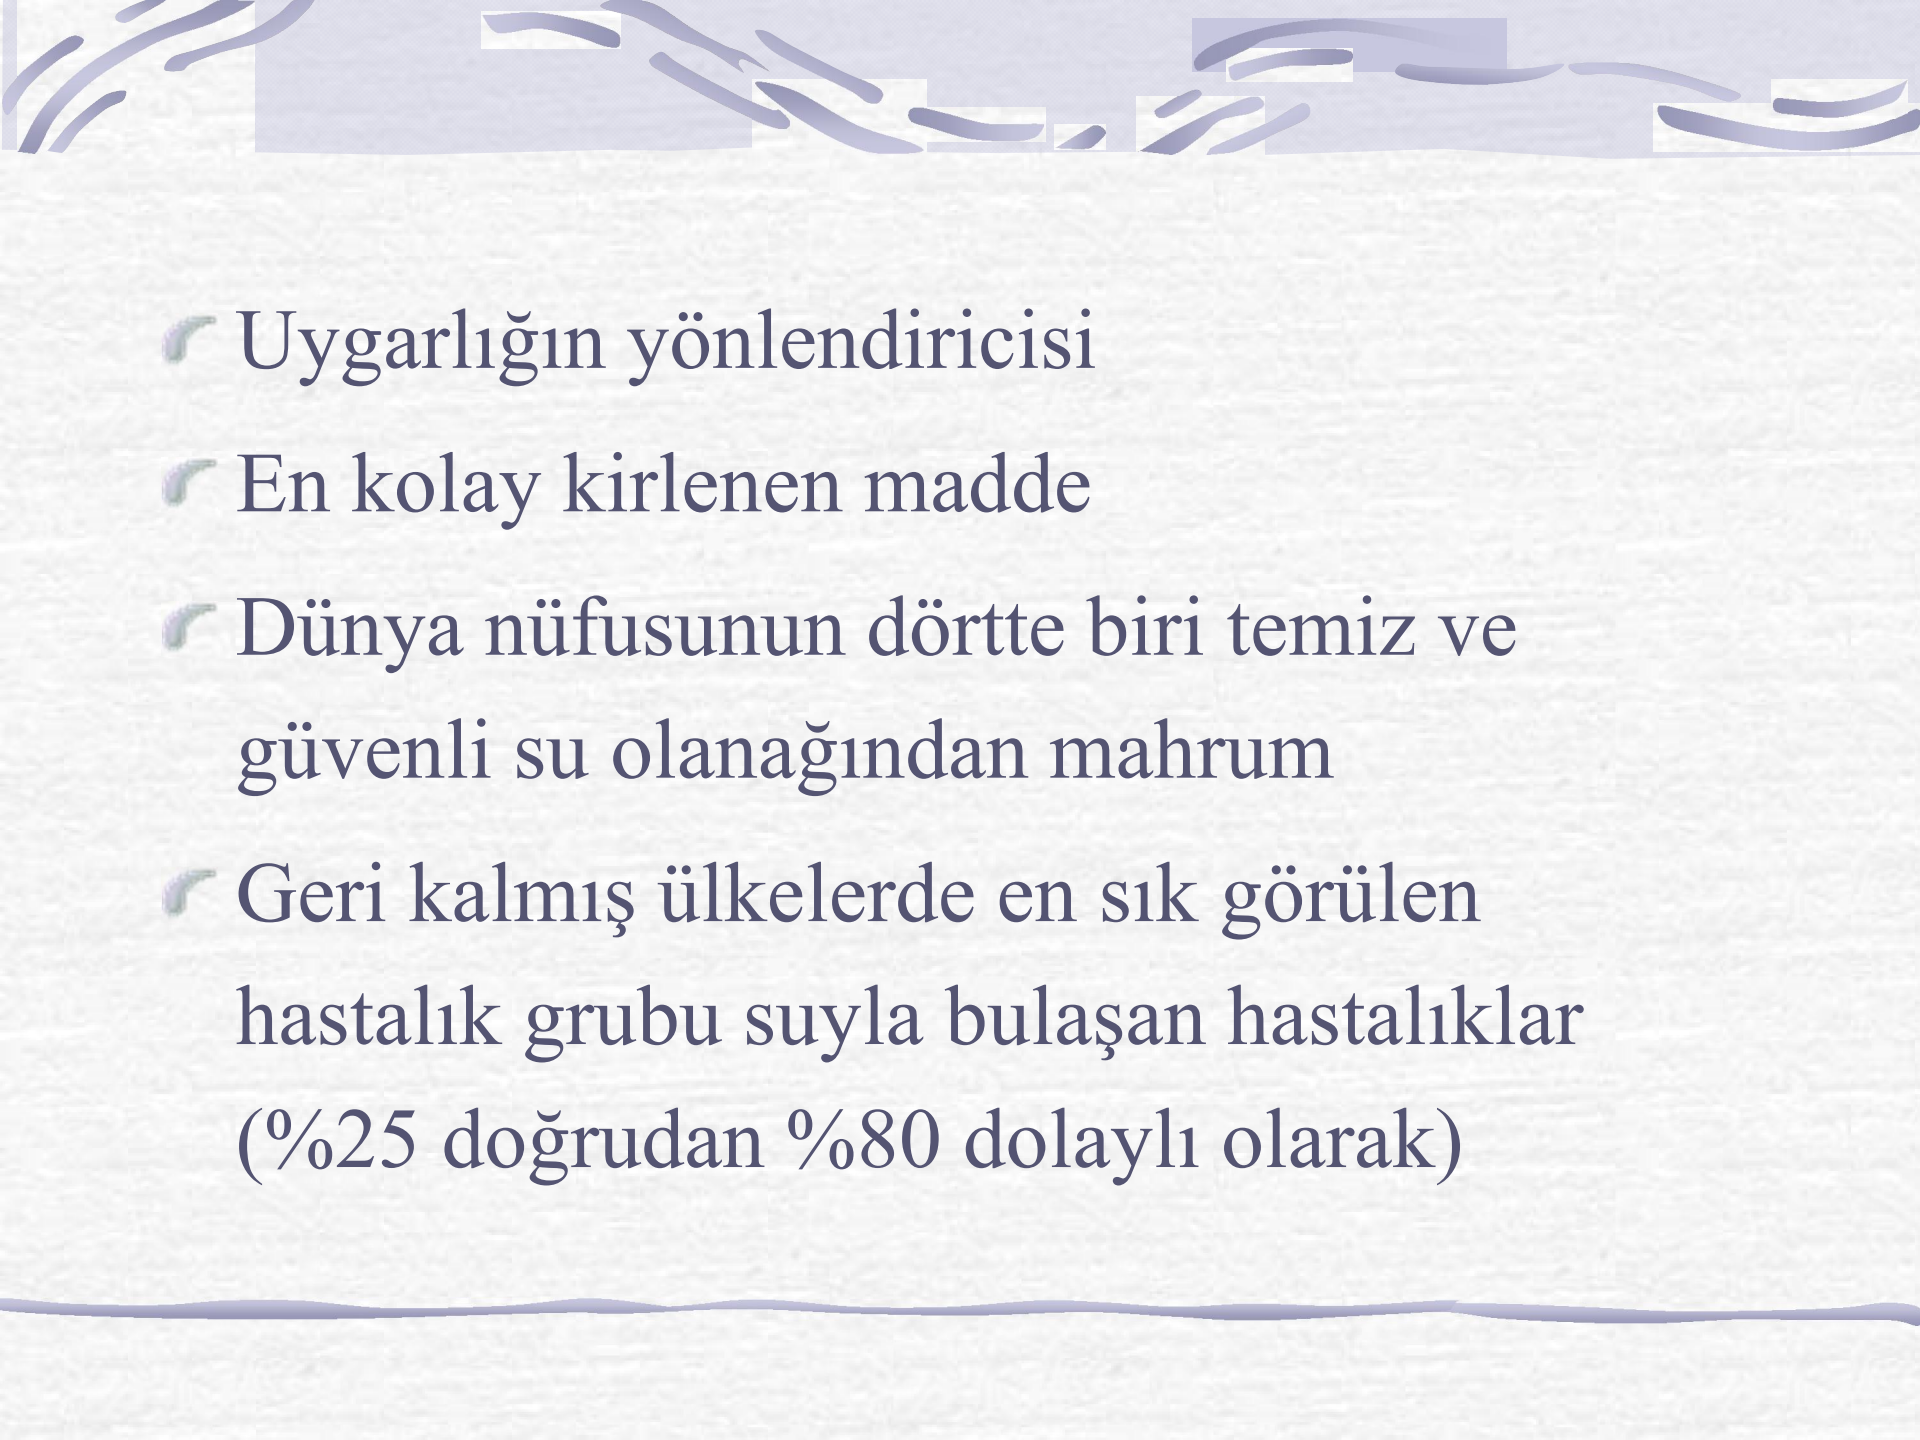

- 
- Uygarlığın yönlendiricisi
 - En kolay kirlenen madde
 - Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum
 - Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar (%25 doğrudan %80 dolaylı olarak)

Temiz ve sađlıklı su

- ☛ Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen su
- ☛ Sađlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren su
- ☛ *İçilebilir su= Olađanıüstü kořullarda temiz, olađan kořullarda sađlıklı su*


Su örneđi alma

Fiziksel ve kimyasal analiz için


- Cam veya PET řiře
- Temiz (HCl ile ve numune alınacak su ile alkalanmıř)

Bakteriyolojik analiz için


- Koyu renkli steril cam řiře
- Kapak veya plastik tıpa

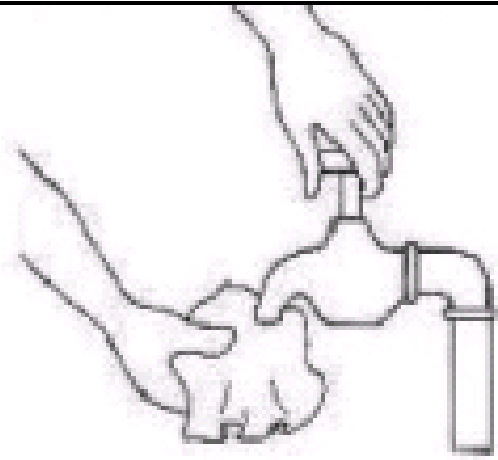


1

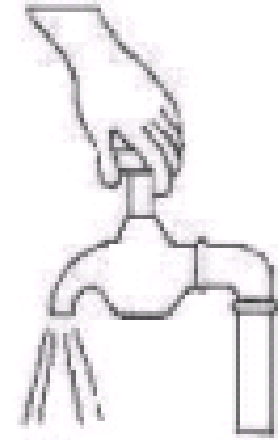

2

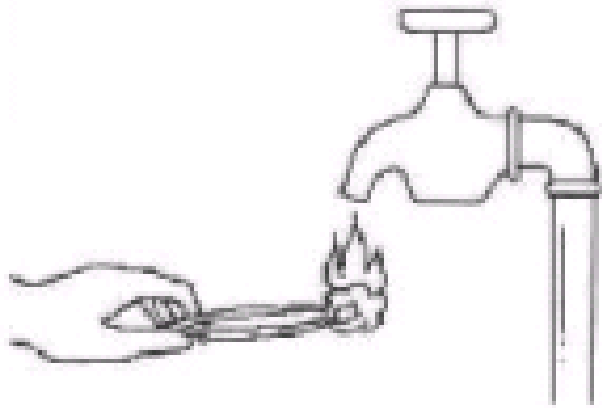


3

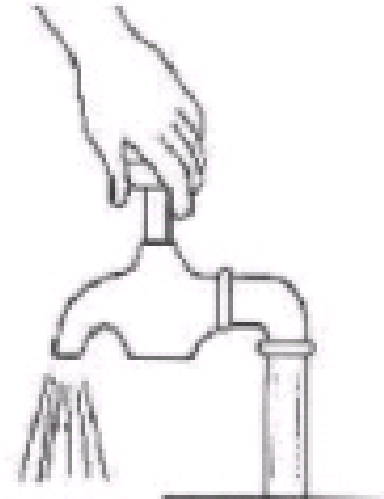

4



5

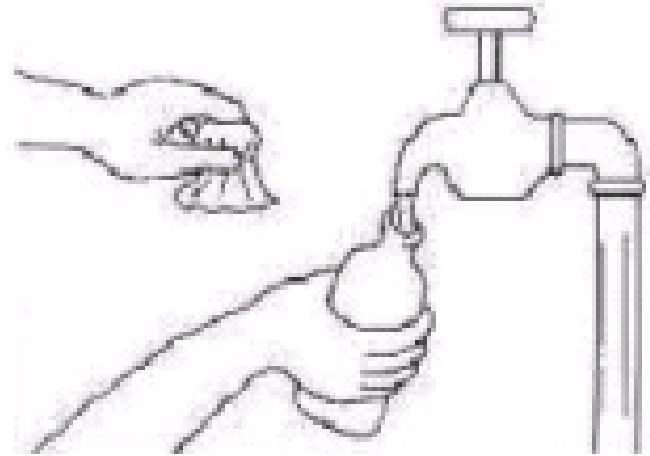







6



7



8

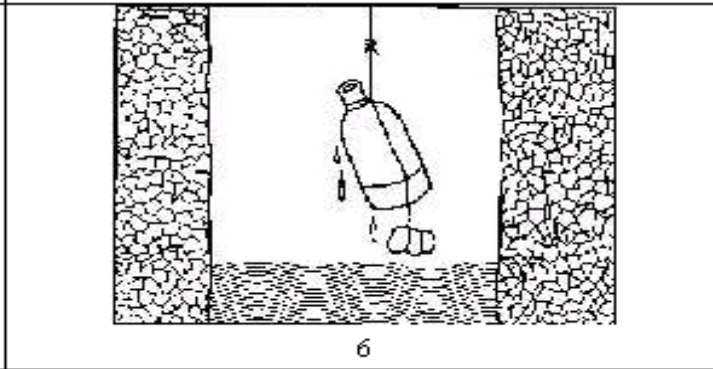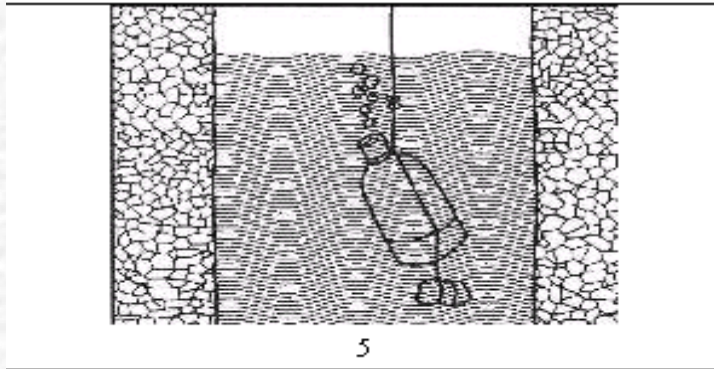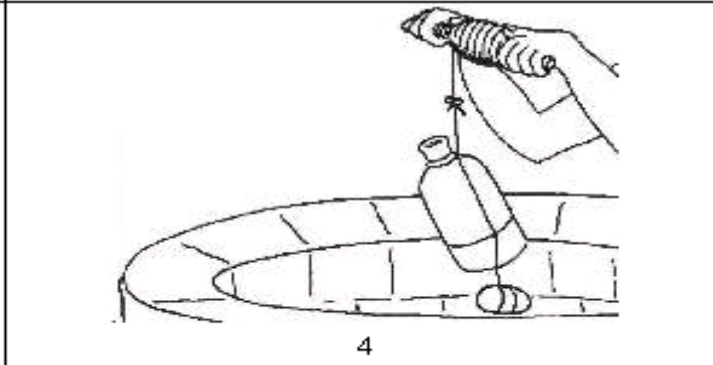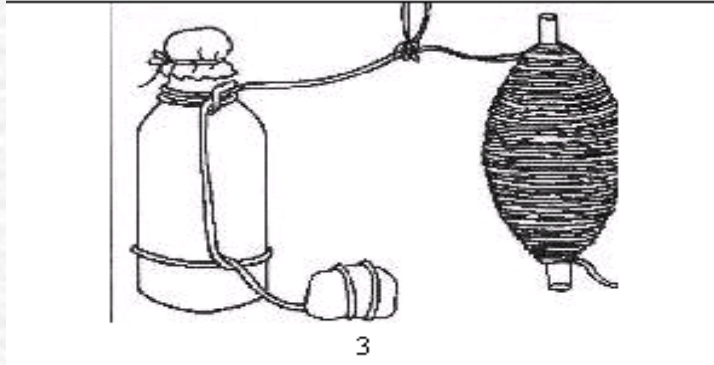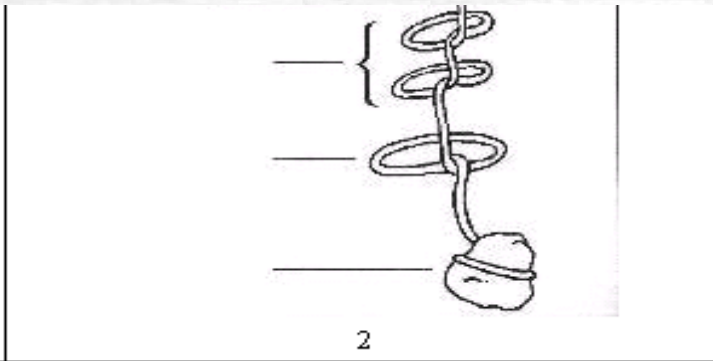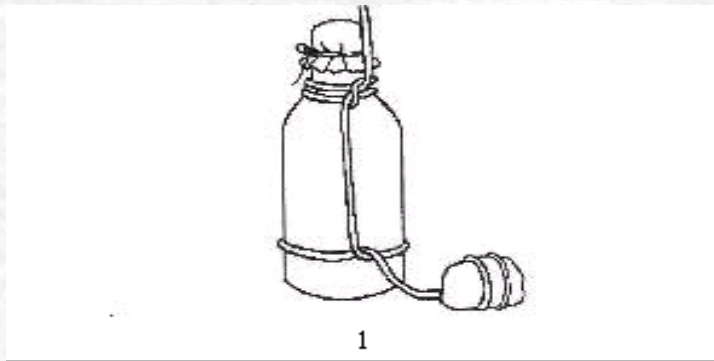


Etiket

- Örneğin alındığı suyun cinsi (şehir şebeke, kuyu, depo)
- Örneğin alındığı yer (ayrıntılı)
- Örneğin alındığı tarih (gün, ay, yıl, saat)
- Örnek alındığında hava sıcaklığı
- Örneğin alındığı suyun sıcaklığı
- Örneği alanın kimliği
- Laboratuvara gönderilen üst yazının no'su



FİZİKSEL VE KİMYASAL SU ANALİZ TEKNİKLERİ

- **Gravimetrik teknikler**
 - **Titrasyon**
 - **Elektrokimyasal teknikler**
 - **Spektrofotometrik ve kolorimetrik teknikler**
 - **Kromatografi**
 - **Kütle spektrometresi**
- 

GRAVİMETRİK TEKNİKLER

Ağırlığa dayalı analizler

- Hassas teraziler kullanılarak yapılır
- Askıda katı madde, sudaki toplam katı analizleri, suyun özgül ağırlığının ölçümü
- Çevresel su örneklerinin, içme suyu ve atıksuların arıtım aşamalarının değerlendirilmesinde

TİTRASYON

İyi tanımlanmış kimyasal bir reaksiyonun kullanılarak örnekteki belirli miktar madde ile reaksiyona girecek standart solüsyon miktarının belirlenmesi esasına dayanır.

- Analizin sonlandırılacağı durum → incelenen sıvının renginde bilinen bir değişim
- Sonlandırma zamanı elektrokimyasal tekniklerle de belirlenebilir.

ELEKTROKİMYASAL TEKNİKLER

Tüm atomların ve moleküllerin dış kısımları elektron tabakalarından oluşmuştur ve kimyasal reaksiyonlar bu elektronlarla ilişki içerisinde meydana gelir.

- Altın, gümüş, platinyum, bakır veya yarıgeçirgen zarlar (pH), dahili elektrodlar ve dolgu sıvıları
- Doğrudan ölçüm **X** sık kalibrasyon

SPEKTROFOTOMETRE VE KOLORİMETRE

Bir solüsyonun renk yoğunluğunu ölçerek elde edilen değeri belirli bir maddenin yoğunluğu ile ilişkilendirme prensibine dayanır.

- Kolorimetre görünebilen renklerle ölçüm yapar → interferans.
- Spektrofotometre: Işık kaynağı ölçümden önce spektrumlarına ayrılarak interferans ortadan kaldırılır.
- Atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS)
- Atomik emisyon spektrofotometresi
- Inductively coupled plasma spectrometry (ICP)

KROMATOĞRAFİ

Renk grafiđi veya renk resmi

- İnce tabaka kađıt kromatografisi (İTK)
- Gaz kromatografİ (GC)
- High pressure (high performance) liquid chromatography (HPLC)
- Sıvı kromatografİ (LC)
- İyon kromatografİ (IC)

KÜTLE SPEKTROMETRESİ (MS)

- İyonize hale getirilmiş buhar manyetik veya radyofrekans özellikteki bobinler arasından geçirilerek karışım içindeki iyonlar kütlelerine göre (elektriksel yük/kütle) ayırma tabi tutulurlar.
- Her madde kendine özgü karakteristik bir patern oluşturur ve bu patern cihazın bilgisayarındaki kütüphanedeki verilerle karşılaştırılarak tanımlanır.

MİKROBİYOLOJİK SU ANALİZİ

- İndikatör mikroorganizmalar
- Çoklu Tüp yöntemleri
- Membran filtrasyon yöntemleri

İNDİKATÖR MİKROORGANİZMALAR

- *Escherichia coli*
- Termotoleran (Fekal) Koliform Bakteri
- Koliform Organizmalar (Toplam Koliformlar)
- Fekal Streptokoklar
- Sülfid İndirgeyen *Clostridium*lar
- Bakteriofajlar
- Heterotrofik Plate Sayımı (koloni sayımı)
- *Aeromonas* türleri ve *Pseudomonas aeruginosa*

(1885)

Londra'da Koch'un katı jelatin
besiyerini kullanarak rutin bakteriyolojik
analizlere başlandı

[Percy ve Grace Frankland]

Theodor von Escherich (1857-1911) anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkıсында *Bacterium coli commune* (*Bacillus coli*)'yi tanımladı (1885).

Bu bakteri 1919 yılında Castellani ve Chalmers tarafından Escherichia coli olarak adlandırıldı.

THEODOR ESCHERICH.



Escherich.

(1893)

‘**Wurtz method**’ kullanılmaya başlandı.

Bu yöntem turnusollü laktozdan asit oluşumu mekanizması ile B. coli sayısını saptama esasına dayanıyordu.

B.coli'nin gaz oluřturma özelliğinden yararlanarak Durham tüpü ile B.coli miktarını saptama yöntemi geliştirildi

[**Durham, H.E. (1893)** A simple method for demonstrating the production of gas by bacteria. *BMJ.* **1**, 1387]


(1901)

İngiltere’de *B.coli*’nin özelliklerini taşıyan bakteriler için “koliform” ifadesi kullanmaya başlandı.

1907 yılında B.coli’nin çok büyük oranda fekal kaynaklı olduğu diğer koliformların ise farklı kaynaklardan olduğu iddia edildi
[Winslow ve Walker]



MacConkey 128 farklı koliform türünün olduğunu saptadı (1909).

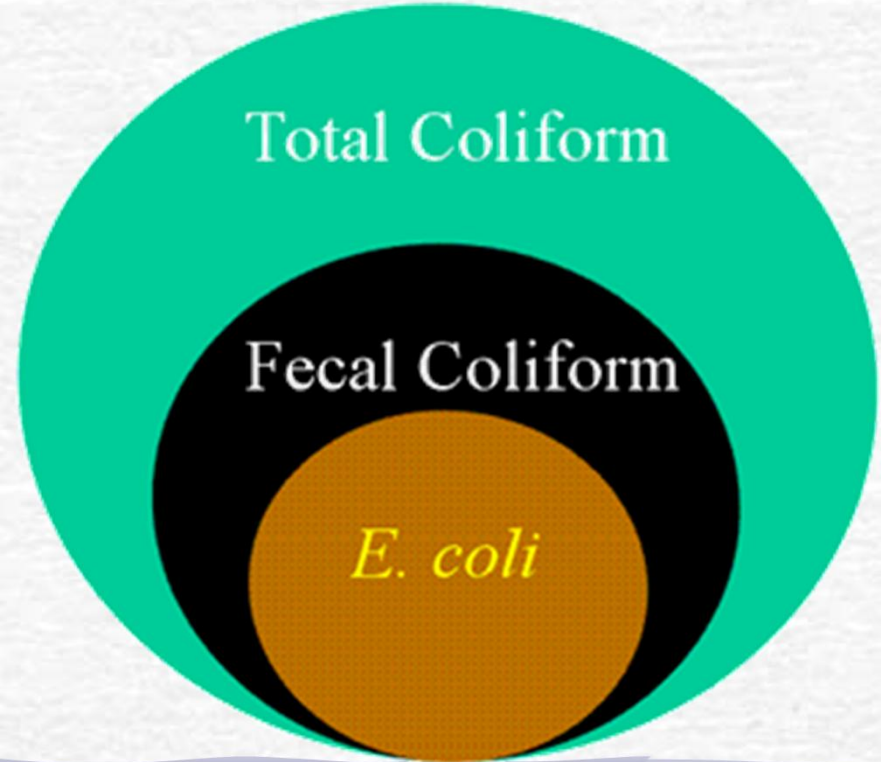

(1915)

Suların mikrobiyolojik analizi için çok tüplü fermentasyon yöntemiyle birlikte kullanılan en olası sayı (**MPN**) metodunu geliştirdi.

[McCrary M.H. The Numerical Interpretation of Fermentation Tube Results. J. Infect. Dis. 1915; 17: 183]

Rusya ve Almanya'da 1940'ların başında arařtırmacılar
membran filtrelerdeki bakterileri kltre etmeye
alıřıyorlardı.



Almanya'da içme sularının mikrobiyolojik analizi için membran filtrelerle birlikte Endo-broth kullanmaya başlandı [Mueller]



1950'ler membran filtrasyonun altın dönemi oldu, ancak gaz oluşumunu gösterememesi büyük bir eksiklik olarak değerlendirildi.

Başvurulabilecek Kaynaklar

- ☛ Su Hijyeni
(<http://www.suhijyeni.com>)
- ☛ TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
(<http://www.halksagligi.org/bulten/>)
- ☛ EPA Sitesi Su Bölümü
(<http://www.epa.gov/ebtpages/water.html>)